


# オゼンピック®皮下注2mgを正しく使うために **ダイジェスト版**

オゼンピック®皮下注2mgを使用される方へ

監修:新潟薬科大学薬学部臨床薬学教育研究センター センター長・教授  
朝倉 俊成 先生

## 注射針の取り付け 手指を石けんでよく洗ってください。


1 オゼンピック®のキャップをはずし、ゴム栓をアルコール綿で拭きます。

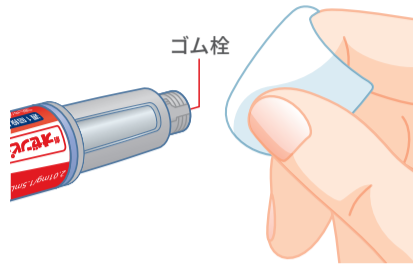


2 注射針をゴム栓にまっすぐ奥まで刺し、止まるまで回します。

注射針の保護シールをはがしたら、後針が曲がっているなどの異常がないか、確認します。

後針

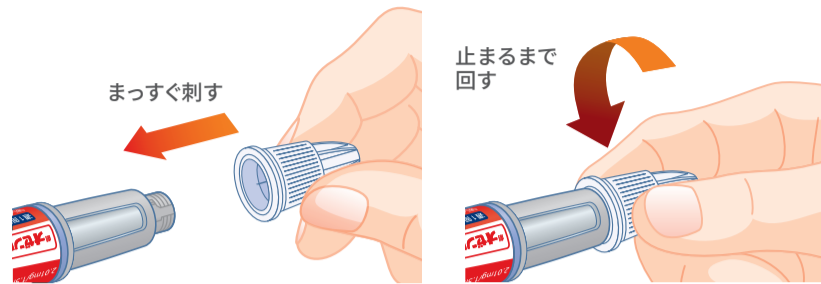

3 「針ケース」と「針キャップ」をまっすぐ引っぱってはずします。

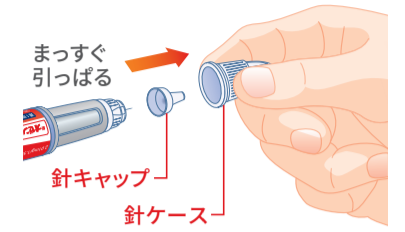

新しいペンを使用する場合


ペンの使用が2回目以降の場合

## 新しいペンを使用する前に

動作確認

2回目以降は動作確認は不要です。


a ダイヤル表示が「0」であることを確認したうえで、ダイヤルを「点線目盛(0のすぐ後)」に設定します。

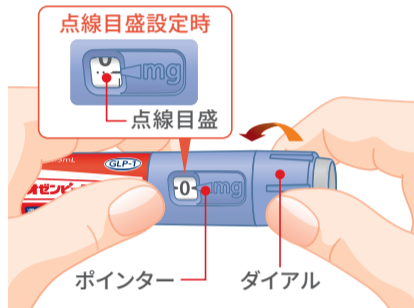

b カートリッジ内の気泡を上部に集めます。



c 針先を上に向けたまま、注入ボタンを押し込みます。

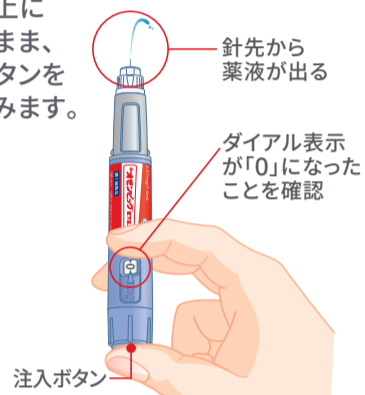


## 投与量の設定

4 ダイヤル表示が「0」になっていることを確認のうえ、ダイヤルを回して、指示された量(0.25mg、0.5mg、1.0mgのいずれか)をポインターに合わせます。




## 注射


5 注射部位を消毒し、注射針を皮膚の面に対して、まっすぐに根元まで刺してください。

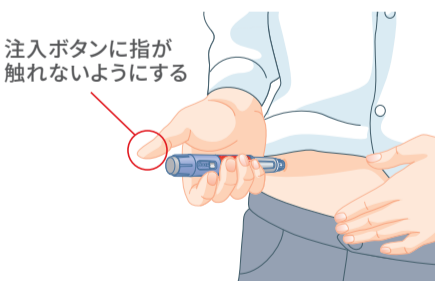


6 「カチッ」と音がするまで注入ボタンを真上から押してください。

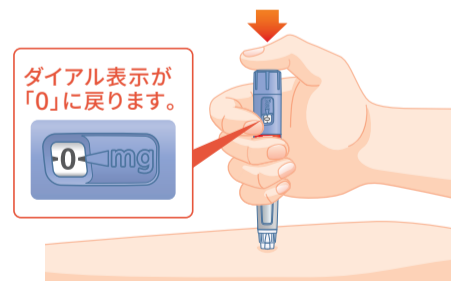

7 完全に薬液を注入するため、注入ボタンを押した状態で、6秒以上注射針を刺したままにしてください。

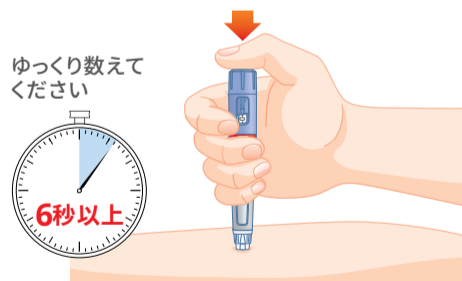


8 注入ボタンを押したまま注射針を抜いてください。

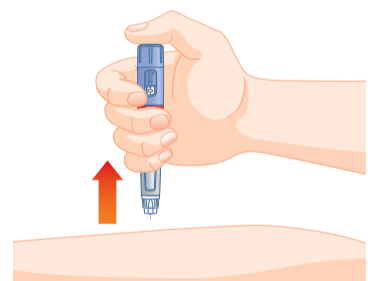

## 注射が終わったら 注射後は必ず直ちに注射針をはずしてください。


9 注射針に「針ケース」をまっすぐつけ、針ケースごと回します。

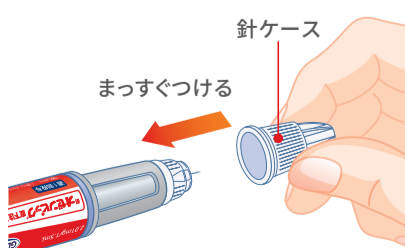


●針キャップはつけないでください。




10 まっすぐ引っぱって注射針をはずします。

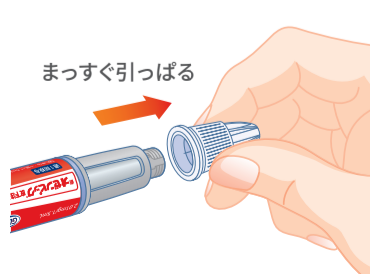

はずした注射針は、後針が折れているなどの異常がないか確認したうえで、**廃棄**します。



11 ペンにキャップをつけます。

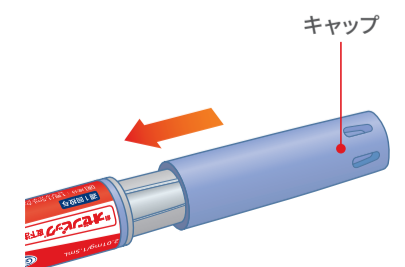

詳細については、製品に添付されている「取扱説明書」をご覧ください。また、自己注射は、主治医の説明を聞いた上で行ってください。

## オゼンピック®の投与量

投与のタイミングは毎週行っている活動や習慣などと組み合わせ、忘れずに投与できるようにしましょう。

### 開始用量

### 維持用量

### 治療の強化



### 開始用量

#### 開始

週1回0.25mgを4週間続けます。

### 維持用量

#### 4週間後

週1回0.5mgに増量し、4週間続けます。

### 治療の強化

#### それぞれの患者さんの状態に応じて

週1回0.5mgを継続するか、1.0mgまで増量する必要があるかは、主治医が判断します。

## 故障かなと思ったら

現象	原因	対処法
初期状態	カートリッジの中に気泡がある	注射針を交換したときにカートリッジの中に気泡が入った可能性があります。 針先を上に向けてオゼンピック®を持ち、カートリッジの上部を指で軽く数回はじいて、カートリッジ内の気泡を上部に集めた後、「新しいペンを使用する前に」の方法で薬液が出ることを確認してから注射をしてください。 ●カートリッジ内の小さな気泡は完全に打ち出すことはできませんが、これは異常ではなく、薬液が出ることが確認されていれば、注射に影響はありません。
	注射針が取り付けられない	注射針に異常がある可能性があります。 ①、②の順で対処してください。 ①注射針を交換してください。 ②注射針を交換しても取り付けられない場合は、新しいペンに交換してください。
	主治医から指示された量に設定できない ダイヤルが回らない	残量が不足しています。 (カートリッジ内の残量以上の量は設定できません。) 新しいペンに交換してください。
新しいペンを使用する前に	「新しいペンを使用する前に(動作確認)」で、薬液が出ない	注射針が曲がっている、または針穴が詰まっています。 新しい注射針に交換してください。 ●注射針は「注射針の取り付け」の説明どおり正しく取りつけてください。また、使用前に注射針を曲げたり傷つけたりしないでください。 ●「新しいペンを使用する前に」の方法で、薬液が出ることを確認した後、注射を行ってください。
注射	ダイヤル表示が「0」に戻っていない	注射針が曲がっている、または針穴が詰まっているため、薬液が出ていません。 新しい注射針に交換してください。 ●注射針は「注射針の取り付け」の説明どおり正しく取りつけてください。また、使用前に注射針を曲げたり傷つけたりしないでください。 ●「新しいペンを使用する前に」の方法で、薬液が出ることを確認した後、注射を行ってください。
		注入ボタンを押してダイヤルが回り始めてから、ダイヤル表示が「0」になるまでに時間差があるために、注入ボタンから指を離してしまった可能性があります。 注入ボタンを、ダイヤル表示が「0」になるまで押し続けてください。注射針を抜いた後に気づいた場合は、設定した量の一部の薬液が注射されなかったおそれがあります。主治医に相談してください。

●当社は、厳密な品質管理のもとにオゼンピック®を皆様のお手元にお届けしておりますが、万一故障や何らかの不具合がある場合は決して使用せず、医療従事者に相談してください。

## 注射を忘れてしまった場合

### 次の投与予定日まで2日(48時間)以上の場合

気づいた時点で直ちに1回分を投与し、その後はあらかじめ決められた曜日に投与してください。

例)月曜日が投与日の場合



### 次の投与予定日まで2日(48時間)未満の場合

忘れた分は投与せず、次の投与予定日に1回分を投与してください。

倍の量を投与するなど、忘れた分を埋め合わせないでください。

弊社製品に関するお問い合わせ(治療内容に関しましては、主治医にご相談ください)

### ノボケア相談室



月曜日から金曜日  
(祝日・会社休日を除く)

☎ 0120-180363



夜間及び  
土日・祝日・会社休日

(注) お問い合わせ内容によっては、翌営業日に回答させていただく場合がございます。

☎ 0120-359516